


CHECKLISTE

Instrumentenaufbereitung nach einem validierten Verfahren.

Jetzt sind Sie gefordert.

Kreuzen sie bitte nur an, wenn auch tatsächlich **jeder** Aufbereitungsschritt in Ihrem **Freigabeprotokoll belegt** ist. Gesichert durch

SAA Standardarbeitsanweisung ggf. **PI** Prüfindikator und **DOKU** Dokumentation

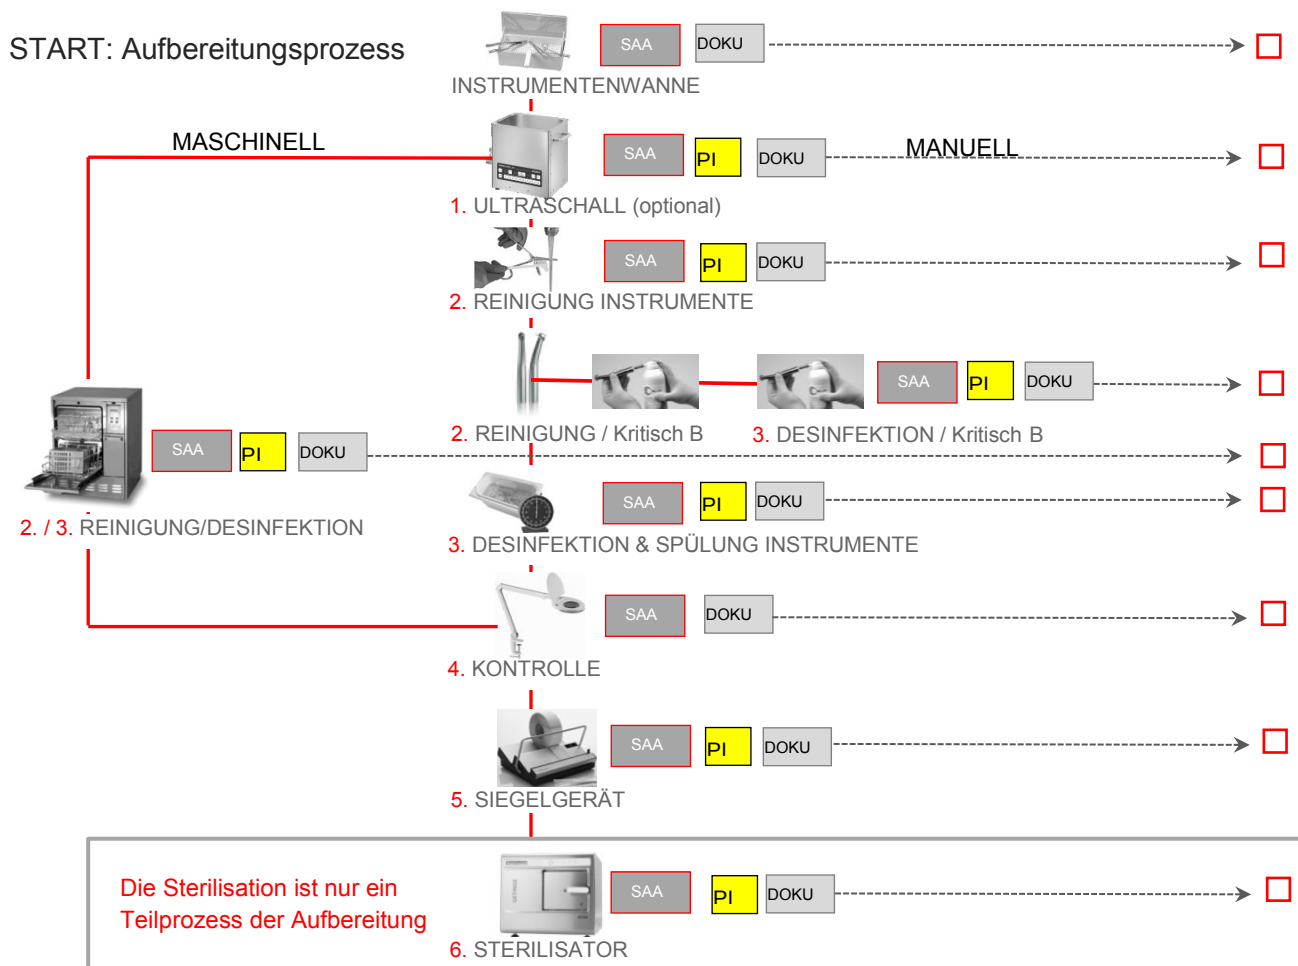

ENDE: Aufbereitungsprozess **Freigabeprotokoll** vollständig Ja Nein

Prüfen Sie selbst.

Fehlen im Ergebnis bei Ihrem Aufbereitungsverfahren ein oder mehrere Kreuze, ist Handlungsbedarf gegeben. Die Dokumentation ist unvollständig, eine Freigabe darf nicht erteilt werden. Im Streitfall ist mit Regress- und Schadensersatzforderungen zu rechnen.

Nutzen Sie unseren Gutschein für eine umfassende

- Analyse der Instrumentenaufbereitung mit konkreten Handlungsempfehlungen für Ihre Praxis. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine
- rechtssichere & validierte Instrumentenaufbereitung in Ihrer Praxis etablieren können.